




## Pravilo odlučivanja ZZJZ KIKINDA 685/2019

U skladu sa dokumentom, ILAC-G8:09/2019, Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity, Laboratorijska ispitivanja ZZJZ Kikinda, je za procenu usaglašenosti rezultata sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilnicima/Uredbama ili specifikacijama proizvoda, odabrala pravilo jednostavnog prihvatanja, način opisan u tački: 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule ( $w=0$ ), koji je prikazan na sledećem grafikonu:



$U = 95\%$  expanded measurement uncertainty

U slučaju dobijenih graničnih vrednosti rezultata ispitivanja laboratorija preuzima nivo rizika i daje rezultat sa nivom poverenja ispod 95% u odnosu na granice izračunate merne nesigurnosti. U izveštaj o ispitivanju koji sadrži izjavu o uslaglašenosti/usklađenosti jasno se identifikuje na koje se rezultate izjava primenjuje i koji rezultati ispunjavaju ili ne ispunjavaju zahteve propisane u odgovarajućim Pravilnicima/Uredbama ili specifikaciji proizvoda. Izjave o usaglašenosti/ usklađenosti se u zavisnosti od dobijenog rezultata ispitivanja navode na sledeći način:

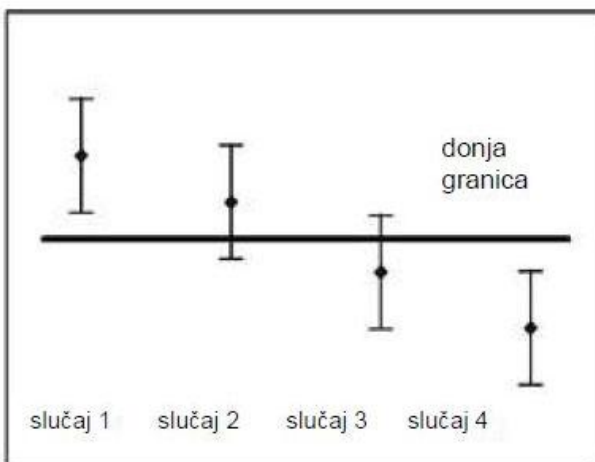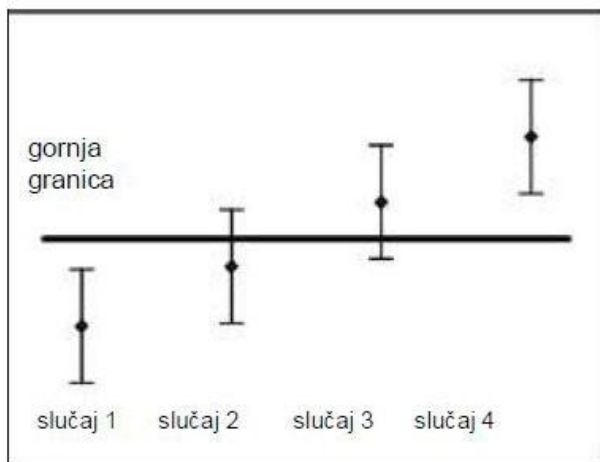

	Opis	Objašnjenje
Slučaj 1	Rezultat merenja sa proširenom mernom nesigurnošću je u propisanim graničnim vrednostima	Objašnjenje: Na osnovu rezultata analiziranih parametara uzorak je usaglašen sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilniku/Uredbi ili specifikaciji proizvoda
<b>Izjava o usaglašenosti: Rezultat je USAGLAŠEN sa propisanim vrednostima</b>		
Slučaj 2	Rezultat merenja je u propisanim granicama, a interval proširene merne nesigurnosti prelazi propisane granične vrednosti	Objašnjenje: Na osnovu rezultata analiziranih parametara uzorak je usaglašen sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilniku/Uredbi ili specifikaciji proizvoda (napomena: usaglašenost se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, za "određeni parameter", odnosno postoji verovatnoća da se rezultat nađe i izvan propisane granice)
<b>Izjava o usaglašenosti: Rezultat je USAGLAŠEN sa propisanim vrednostima</b>		
Slučaj 3	Rezultat merenja je izvan propisanih granica, a interval proširene merne nesigurnosti obuhvata deo dozvoljenih vrednosti	Objašnjenje: Na osnovu rezultata analiziranih parametara uzorak je neusaglašen sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilniku/Uredbi ili specifikaciji proizvoda (napomena: neusaglašenost se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, za "određeni parameter", odnosno postoji verovatnoća da se rezultat nađe i unutar propisane granice)
<b>Izjava o usaglašenosti: Rezultat NIJE USAGLAŠEN sa propisanim vrednostima</b>		
Slučaj 4	Rezultat merenja sa proširenom mernom nesigurnošću je izvan propisanih graničnih vrednosti	Objašnjenje: Na osnovu rezultata analiziranih parametara uzorak je neusaglašen sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilniku/Uredbi ili specifikaciji proizvoda Izjava o usaglašenosti:
<b>Izjava o usaglašenosti: Rezultat NIJE USAGLAŠEN sa propisanim vrednostima</b>		

Ako je rezultat merenja jednak granici specifikacije, tada se postupa kao u slučaju 2.

Zavod za javno zdravlje Kikinda

Datum: 01.10.2019